


新型コロナウイルスの不活化効果速報

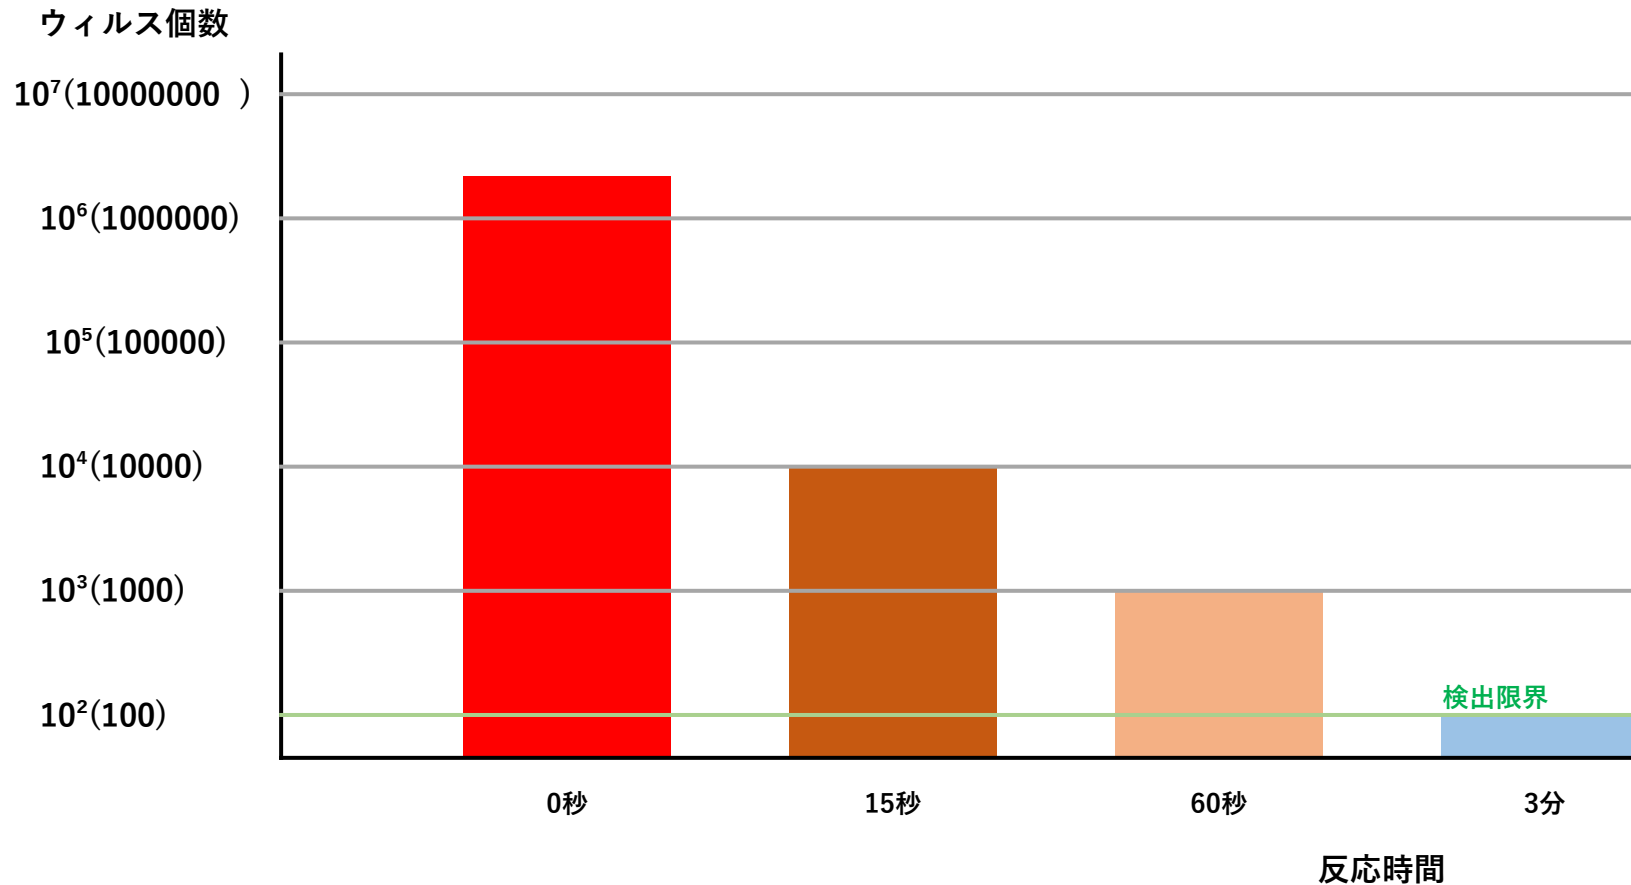

株式会社フジ医療器は、第三者機関の協力のもと、オゾン水ミストが新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）の不活化に効果のある事を確認した。シャーレーに塗抹した新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）に対して、電気分解法により生成したオゾン水を噴霧した結果、15秒で100分の1（約99%）60秒で1000分の1（約99.9%）3分で検出限界以下の不活化を確認した。

注意点

- I：資料をコピーして配らない事、見せるのみ
- II：検査機関は第三者機関と濁してください
- III：あくまでも速報で正式な報告書でないこと
- IV：ウィルス不活化試験結果と商品を直接結び付けない
あくまでもオゾン水で効果がありました・・・程度
- V 資料にはIVである通り、トレビ・クリアゼロの商品名は一切入れていません。

＊新型コロナウィルス＝SARS-CoV-2

新型コロナウィルス感染＝COVID-19になります